技术规格

| 量 程 | 10ppm | 20ppm | 100ppm | 1000ppm | 2000ppm | 10000ppm |
|-----------|--------------------|-----------|----------|----------|------------|------------|
| 分辨率 | 1ppb | 5ppb | 25ppb | 250ppb | 500ppb | 2ppm |
| 灵 敏 度 | >40mV/ppm | >20mV/ppm | >5mV/ppm | >1mV/ppm | >0.3mV/ppm | >0.1mV/ppm |
| 检测气体 | VOC,能量≤10.6eV挥发性气体 | | | | | |
| 工作电压 | 3.2~5.5V | | | | | |
| 零点电压 | Uo>20mV | | | | | |
| 输出信号电压 | 0.02~2.5V (最大3.0V) | | | | | |
| 响应时间(T90) | ≤5秒 | | | | | |
| 工作温度 | -40~60°C | | | | | |
| 精 度 | ≤±2%校准点 | | | | | |
| 湿 度 | 0~99%无凝露 | | | | | |
| 工作压力 | 800~1200mbar | | | | | |
| 储存温度 | 0~25°C | | | | | |
| 质 保 | 12个月 | | | | | |

注意事顶:

- 首次使用传感器,需最少预热半个小时以上;
- 校准时,需等传感器完全稳定后操作,零点需在干燥的洁净空气中进行;
- 校准时,建议使用50%量程左右的异丁烯气体作为校准气体;
- 禁止带电对传感器热拔插;
- 禁止焊接传感器引脚,需使用配套插针进行连接,插针允许焊接;
- 传感器不可经受过度的撞击和振动;
- 请勿将该传感器应用于涉及人身安全的系统中;
- 请勿将传感器安装在强空气对流环境下,避免气压来回变化,导致示值波动或传感器损坏;

■ 请勿长期在超过传感器量程的环境中使用或存储。

河北慧感电子科技有限公司

地址: 石家庄市丰收路保利花园B3-1-2904 电话: 0311-67907232 13691540971

网站: www.hgsensor.cn




4R-PID光离子化 传感器说明书






PID传感器由真空紫外灯、低噪声检测电路和电离室构成的光离子化传感器,所谓的离子化就是用高于或等于待测气体的能量迫使待测气体"分裂",把待测气体中的电子激发出来,"分裂"的每个部分都带有相应的电荷,在PID中,激发待测气体离子化的源头就是电离室中的紫外灯。因此,在使用PID之前要清楚被测气体发生电离所需的能量及PID的能量源本身所能够提供的输出能量。VOC气体被离子化所需要的能量被称为电离电位(简称为IP),其计量单位为电子伏特(EV)。PID中采用紫外灯作为能量输出源,其输出能量的单位也是EV,因此,当紫外灯的输出能量高于或等于待测气体的IP值时,此待测气体可以被该紫外灯电离并做进一步检测,否则不能将其离子化。空气中的基本成分为 N_2 、 O_2 、 CO_2 、 H_2O 等 其 IP值都大于紫外灯的输出能量,因此,PID检测泄露在空气中的VOC时可保证空气中的基本组分不被离子化。

外形尺寸8 (单位: mm)

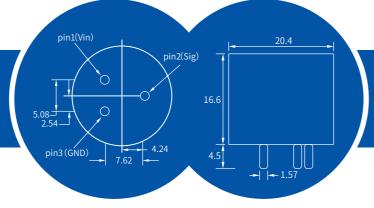

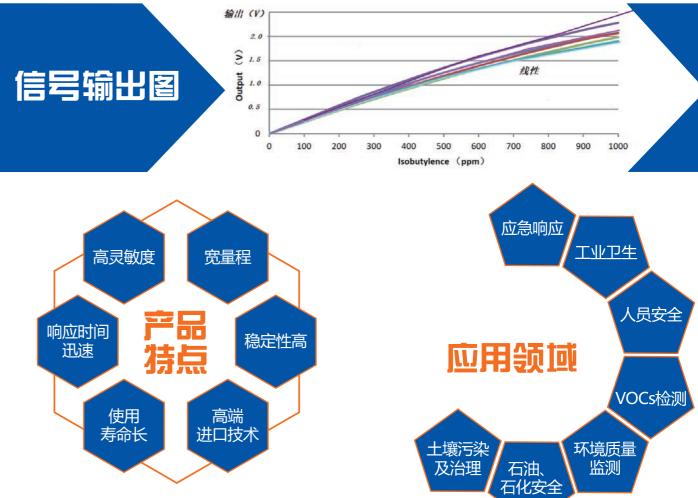

气体响应因子:

异丁烯的灵敏度与目标气体灵敏度之比称为响应因子(RF)。例如,传感器对异丁烯的灵敏度为1MV/PPM,对苯的灵敏度为2MV/PPM,这意味着苯的RF等于0.5,响应因子也因不同PID传感器结构设计的不同而存在一定的差异。在使用响应因子表时,有以下注意事项:

- ◆ 以异丁烯为参照气体,干燥空气为平衡体 在实验室条件下测得的各响应因子;
- ◆ 根据测量条件(样品温湿度、背景气体和 灯况)的不同,在客户应用中响应因子的实际值可 能会有所差异;
- ◆ 当用实际气体校准不可行时,可使用响应 因子进行近似校准。

气体标定及漂移:

传感器对气体的响应可能随时间而变化,造成这种偏差的主要原因是紫外灯的窗户被污染。如果传感器应用于环境空气含有重化合物或粒子的电离,则灯窗将容易受到污染。窗口污染率与样品气体状态的有关,即被化学物质和粒子污染的严重程度,灯窗的污染会导致部分紫外线被阻挡,从而降低PID传感器的灵敏度。在这种情况下,需要更频繁的校准和定期清洗灯窗口。

大部分挥发性有机化合物(如异丁烯、苯等)不会污染窗口,且漂移非常小。然而一些化合物(如硅酮)会很快沉积附着在灯窗上。在这种情况下,漂移可能在8小时内达到10~20%。通常,如果传感器使用在相对清洁的环境中,重新标定周期可以稍长,因此可根据所需的环境及准确度确定标定周期,可选择每月1次至每六个月1次。

3